

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.193-06

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „ATTIVAVITA“ Kontrolės įstaiga

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: UAB „ATTIVAVITA“
juridinio asmens kodas: 302081573

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip C tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2021-10-18**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-04-18**

Dėstoma versija patvirtinta: **2024-04-18**

Pažymėjimas galioja iki: **2026-10-17**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.






AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „ATTIVAVITA“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Visorių g. 8, LT-08300 Vilnius

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Techniniai manometrai, elektrokontaktiniai manometrai (išskyrus savirašius ir deguonies) Matavimo ribos (0...6) MPa Tikslumo klasė (0,4...5)	Metrologinė patikra	BPM 8871101-13:2000 (galioja iki 2024-05-31)
Mechaniniai slėgmačiai su tampriuoju matavimo elementu (išskyrus deguonies slėgmačius, vakuumetrus, manometrus- vakuumetrus, skirtuminio slėgio matuoklius, savirašius) Matavimo ribos (0...6) MPa Tikslumo klasė (0,4...5) %	Metrologinė patikra	BPM 111955219-13:2023 (įsigalioja nuo 2024-06-01)
Mechaniniai šalto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,01...16,0) m³/h Tūrio matavimo paklaida: ± 5 % esant debitui $Q_{min} \leq Q < Q_t$; ± 2 % esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_n$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-57:2002 PAKEITIMAS 1 (galioja iki 2024-04-30)
Mechaniniai karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,01...16,0) m³/h Tūrio matavimo paklaida: ± 5 % esant debitui $Q_{min} \leq Q < Q_t$; ± 3 % esant debitui $Q_t \leq Q \leq Q_n$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-29:2002 PAKEITIMAS 1 (galioja iki 2024-04-30)

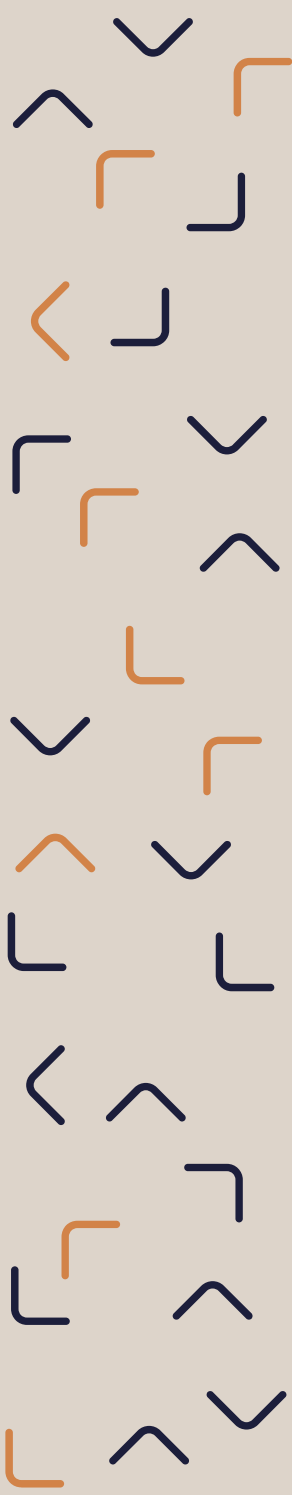

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Šalto vandens ir karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,01 - 16,0) m³/h Tūrio matavimo paklaida: ± 5 % esant srautui $Q_1 (Q_{min}) \leq Q < Q_2 (Q_t)$ ± 2 % esant srautui $Q_2 (Q_t) \leq Q \leq Q_3 (Q_n)$	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023 (įsigalioja nuo 2024-05-01)

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas