



LIETUVOS AKREDITACIJOS IR
STANDARTIZACIJOS AGENTŪRA

Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra – paskirtoji Nacionalinė akreditacijos įstaiga Lietuvoje yra Europos akreditacijos organizacijos ir Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos Daugiašalio pripažinimo susitarimų signatarė kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.202-06

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

UAB „Metrologinės patikros“ Kontrolės įstaiga

LST EN ISO/IEC 17020:2012

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: Metrologinės patikros UAB
juridinio asmens kodas: 305550638

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

matavimų priemonių tikrinimą kaip A tipo kontrolės įstaiga

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2022-06-30**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-02-28**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-05-08**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-06-29**

Akreditacijos departamento direktorius


TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.






AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Metrologinės patikros“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *A tipo kontrolės įstaiga* **LST EN ISO/IEC 17020:2012** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Rodūnios kelias 34, LT-02187 Vilnius

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida $\pm 2\%$ Išmatuoto laiko paklaida $\pm 0,2\%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-90:2016
Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai (0-40) kN Pagamintiems iki 2008 m.: leidžiamoji paklaida. $\pm 3\%$. Pagamintiems po 2008 m.: jėgai, mažesnei kaip 5000 N leidžiamoji paklaida ± 100 N, didesnei kaip 5000 N leidžiamoji paklaida $\pm 2\%$; kairės ir dešinės pusių neidentiško leidžiamoji paklaida $\pm 2,5\%$.	Metrologinė patikra	BPM 120229395-141:2013
Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo stendai Optinės sistemos ir skalės tarpusavio orientavimo paklaida horizontalia kryptimi ir vertikalia kryptimi ± 3 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-102:2006 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Alkoholio koncentracijos iškvėpiamame ore matavimo priemonės, alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo (0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126-1 $\beta < 0,4$ mg/l $\pm \leq (0,02 \dots 0,03)$ mg/l $0,4$ mg/l $\leq \beta \leq 2,0$ mg/l $\pm \leq (5 \dots 7,5)\%$ $\beta > 2,0$ mg/l $\pm \leq ((\beta/2 - 0,9) \dots ((3 \cdot \beta)/4 - 1,35))$ mg/l; pagal LST EN 15964 $\beta \leq 0,2$ mg/l $\pm \leq 0,02$ mg/l $\beta > 0,2$ mg/l $\pm \leq 10\%$	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
Sprogių/degių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai ASR/ AUR matavimo ribos: (5...50) % ASR/AUR Leidžiamoji paklaida $\pm 3\%$ ir didesnė Deguonies dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai Deguonies koncentracijos matavimo ribos: (0,5...100) tūr. %;	Metrologinė patikra	BPM 111950581-121:2025

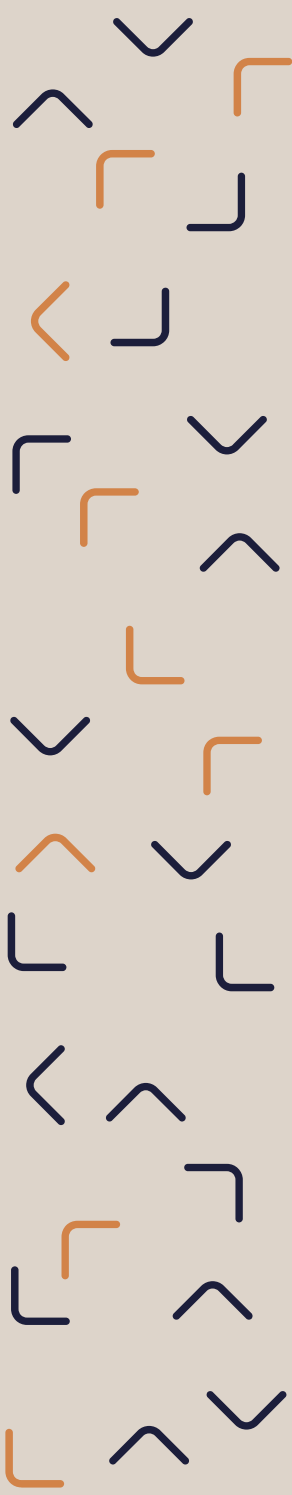

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Leidžiamoji paklaida: $\pm 0,2$ tūr. % O_2 ir didesnė Toksinų dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai Dujų koncentracijos matavimo ribos: 5 tūr. ppm ...100 tūr. %; Leidžiamoji paklaida: $\pm 3\%$ ir didesnė		
Automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai Matavimo ribos: (0,01... 7) tūr. % CO Leidžiamoji paklaida $\pm 3\%$ ir didesnė Matavimo ribos: (0,01...16) tūr. % CO_2 Leidžiamoji paklaida $\pm 4\%$ ir didesnė Matavimo ribos: (0,01...2000) tūr. ppm HC Leidžiamoji paklaida $\pm 5\%$ ir didesnė Matavimo ribos: (0,01... 21) tūr. % O_2 Leidžiamoji paklaida $\pm 3\%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-79:2014
pH matuokliai pH matavimo ribos: (-3...+17) pH Leidžiamoji paklaida $\pm 0,02$ pH ir didesnė Elektrovaros jėgos matavimo ribos (-1900...+1900) mV Leidžiamoji paklaida $\pm 0,2$ mV ir didesnė Savitojo elektrinio laidžio matavimo ribos: 0,01 $\mu S/cm$...12800 $\mu S/cm$ Leidžiamoji paklaida $\pm 1\%$ ir didesnė Ištirpusio deguonies koncentracijos matavimo ribos (0...19) mg/l O_2 Leidžiamoji paklaida $\pm 0,5\%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai Temperatūros matavimo ribos (0...55) $^{\circ}C$, Leidžiamoji paklaida $\pm 0,3\%$ ir didesnė Ištirpusio deguonies koncentracijos matavimo ribos (0...199,9) % (0...600) % O_2 Leidžiamoji paklaida $\pm 0,5\%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-117:2007
Spektrofotometrai Bangos ilgio matavimo ribos (220...900) nm Leidžiamoji paklaida $\pm 0,5$ nm ir didesnė Sugerties matavimo ribos (0...2) A (sant. sugerties vnt.) Leidžiamoji paklaida $\pm 0,002$ A (sant. sugerties vnt.) ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005
Refraktometrai Lūžio rodiklio matavimo ribos (1,32...1,70) n_D ; Leidžiamoji paklaida: $\pm 1 \times 10^{-4} n_D$ ir didesnė; Brix rodiklio matavimo ribos (0...100)% Brix; Leidžiamoji paklaida: $\pm 0,2\%$ Brix ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2010
Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės (dūmomačiai) Šviesos pralaidumo matavimo ribos (0...100) % Leidžiamoji paklaida: $\pm 1\%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-87:2004
Automobilių stiklų šviesos pralaidumo matavimo prietaisas CL 176 RS Šviesos pralaidumo matavimo ribos (0...100) % Leidžiamoji paklaida $\pm 2\%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 122757637-10:2006

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Medienos drėgmės matuokliai Drėgmės matavimo ribos: (7...60) % Leidžiamoji paklaida $\pm 0,2$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-123:2008
Grūdų drėgmės matuokliai Drėgmės matavimo ribos: (0...100) % Leidžiamoji paklaida $\pm 0,5$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-125:2008
Pieno analizatoriai (laktoskopai) Riebalų koncentracijos matavimo ribos (0,5...7)% Baltymų koncentracijos matavimo ribos (2...5)% Laktozės koncentracijos matavimo ribos (3...6) % Leidžiamoji paklaida ± 1 % ir didesnė Temperatūros matavimo ribos (0...-1,500) °C; Leidžiamoji paklaida $\pm 0,0025$ °C ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-124:2008
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai Laiko trukmės matavimo ribos (62...1000) s Leidžiamoji paklaida ± 1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas