

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.059-02

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**UAB „KEMEK Engineering“
Patikros laboratorija**

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: UAB „KEMEK ENGINEERING“
juridinio asmens kodas: 124100661

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

matavimo priemonių kalibravimą

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2025-12-18**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-12-18**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-12-18**

Pažymėjimas galioja iki: **2030-12-17**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.




UAB „KEMEK Engineering“ Patikros laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:


Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:

Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma)	Matavimo neapibrėžtis
Masė	KV 7-26.6 K (2 leidimas, 2025-11-07) pagal EURAMET Calibration Guide No.18, Ver 4.0	Neautomatinės svėrimo priemonės (svarstyklės)	su E2 t. kl. svorsčiais nuo 1 mg iki 610 g	(0,0051+1,02*10 ⁻⁴ *R) mg R-svarstyklių rodmuo, g
			su F1 t. kl. svorsčiais nuo 1mg iki 70 kg	(0,032+1,9*10 ⁻⁴ *R) mg R-svarstyklių rodmuo, g
			su M1 t. kl. svorsčiais nuo 1 kg iki 1500 kg	(0,00048+4,1*10 ⁻⁴ *R) g R-svarstyklių rodmuo, kg
Jėga	KV 7-29.6 K (2 leidimas, 2025-11-07) LST EN ISO 7500-1:2018 išskyrus 6.4.8 p.	Jėgos bandymo mašina, gniuždymas/ tempimas (kalibravimas dinamometrais) (1...10) kN	1 kN	± 0,039 %
			2 kN	± 0,024 %
			3 kN	± 0,024 %
			4 kN	± 0,028 %
			5 kN	± 0,024 %
			6 kN	± 0,020 %
			8 kN	± 0,014 %
			10 kN	± 0,013 %

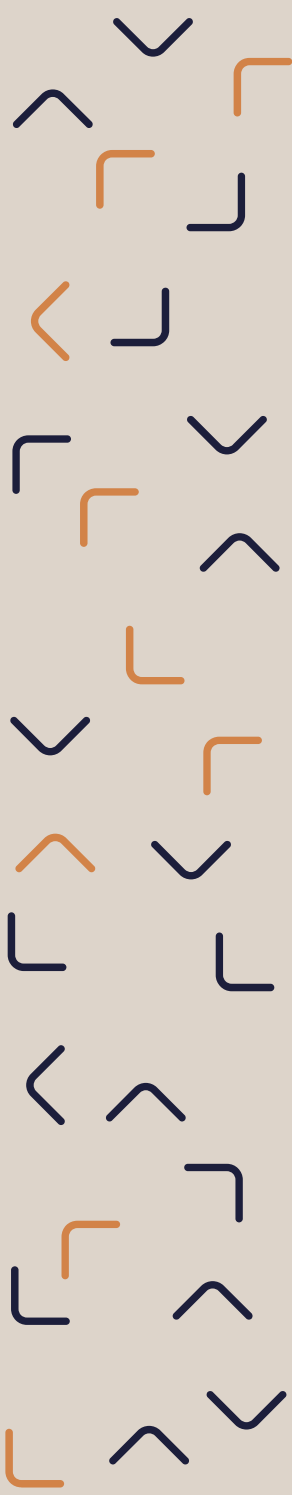

Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:				
Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma)	Matavimo neapibrėžtis
			5 kN	± 0,051 %
			10 kN	± 0,032 %
			15 kN	± 0,028 %
			20 kN	± 0,025 %
			25 kN	± 0,022 %
			30 kN	± 0,018 %
			40 kN	± 0,015 %
			50 kN	± 0,015 %
		Jėgos bandymo mašina, gniuždymas/ tempimas (kalibravimas dinamometrais) (20 ... 200) kN	20 kN	± 0,058 %
			40 kN	± 0,038 %
			60 kN	± 0,028 %
			80 kN	± 0,031 %
			100 kN	± 0,026 %
			120 kN	± 0,024 %
			160 kN	± 0,023 %
			200 kN	± 0,021 %
		Jėgos bandymo mašina, gniuždymas/ tempimas (kalibravimas dinamometrais) (100 ... 1000) kN	100 kN	± 0,033 %
			200 kN	± 0,034 %
			300 kN	± 0,031 %
			400 kN	± 0,032 %
			500 kN	± 0,031 %
			600 kN	± 0,031 %
			800 kN	± 0,031 %
			1000 kN	± 0,031 %
		Jėgos bandymo mašina, gniuždymas/ tempimas (kalibravimas dinamometrais) (300 ... 3000) kN	300 kN	± 0,064 %
			600 kN	± 0,072 %
			900 kN	± 0,063 %

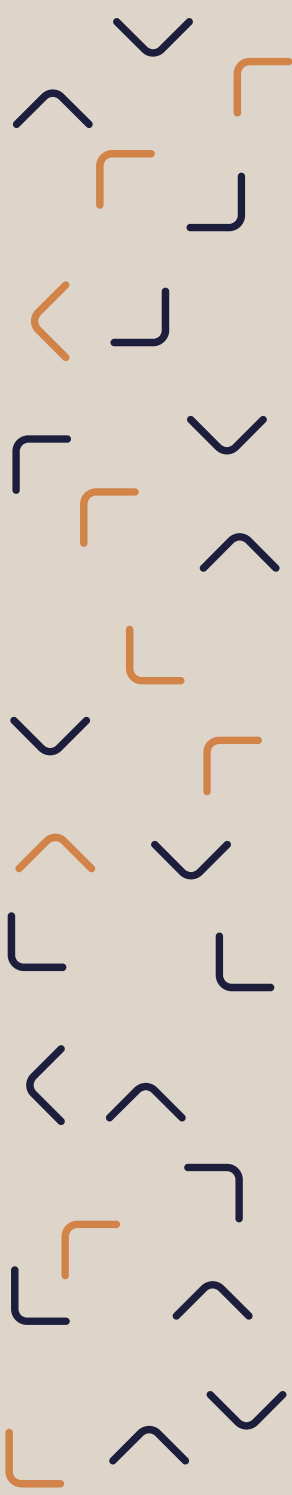

Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:				
Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai (kai taikoma)	Matavimo neapibrėžtis
			1200 kN	± 0,060 %
			1500 kN	± 0,055 %
			1900 kN	± 0,054 %
			2400 kN	± 0,055 %
			3000 kN	± 0,052 %

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas