

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.024-06

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

AB „Achema“ Metrologijos laboratorija

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė "Achema"
juridinio asmens kodas: 156667399

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

matavimo priemonių tikrinimą kaip C tipo kontrolės įstaiga

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje


Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2022-10-27**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2023-11-28**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-06-12**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-10-26**

Akreditacijos departamento direktorius



TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.





Kontrolė
ISO/IEC 17020




AKREDITAVIMO SRITIS

AB „Achema“ Metrologijos laboratorija, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Jonaulukio k. 1, Jonavos sen. 55296 Jonavos r.

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Mechaniniai slėgmačiai su tampriuoju matavimo elementu (išskyrus slėgio savirašius) Matavimo ribos nuo - 100 kPa iki 60 MPa, tikslumo klasė nuo 0,2 iki 5,0	Metrologinė patikra	BPM 111955219-13:2023
Slėgio keitikliai Matavimo ribos nuo -92,0 kPa iki 60 MPa matavimo tikslumas $\pm 0,1$ % ir žemesnis; Slėgio skirtumo keitikliai Matavimo ribos nuo -92,0 kPa iki 1,6 MPa matavimo tikslumas $\pm 0,1$ % ir žemesnis	Metrologinė patikra	BPM 8871101-24:2011
Diafragmos skysčių ir dujų kiekio matavimui Matavimo ribos nuo 12,5 mm iki 400 mm tolerancija nuo 0,075 mm iki 0,240 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-93:2006 p 8.2, Pakeitimas 1
Ižeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės (Analoginiai ohmetrai) Matavimo ribos nuo 0,01 Ω iki 1 G Ω tikslumo klasė 1,0 ir žemesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-66:2002
Neautomatinės mechaninės svarstyklės iki 500 kg, III, IIII tikslumo klasių	Metrologinė patikra	BPM 8871101-19:2000

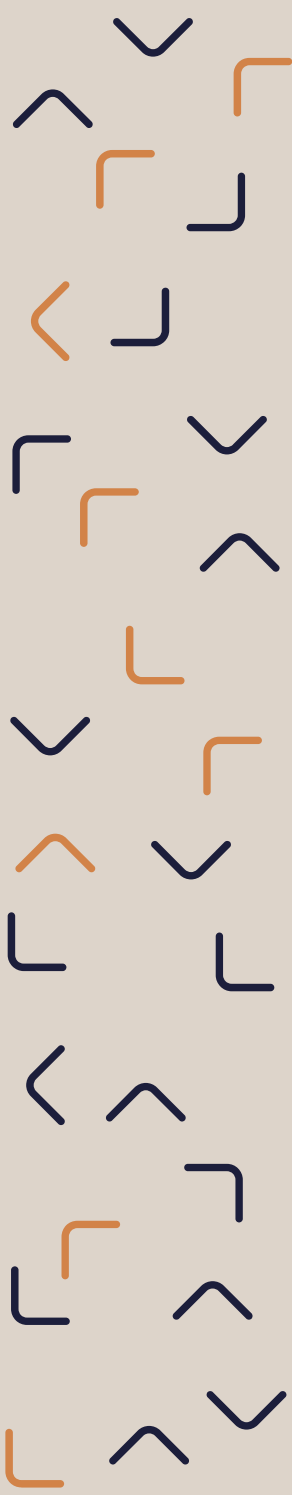

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Neautomatinės elektroninės svarstyklės (išskyrus bunkerines, pakabinamas ir sujungtas su kasos aparatu) Svėrimo ribos iki 500 kg , patikros padalos vertė e≥10 mg II, III, IIII tikslumo klasių Svėrimo ribos iki 500 g, patikros padalos vertė e<10 mg II tikslumo klasės	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Dujų signalizatoriai ŠČIT (rus. ШЧИТ) (5...50) % degių dujų, garų ir jų mišinių ore ASR/AUR Signalizacijos suveikimo paklaida 27,5 ± 22,5 % AUS/AUR	Metrologinė patikra	SPM 156667399-02:2024
Dujų signalizatoriai SVK-3M1 (rus. CBK-3M1) (5...20) % vandenilio-oro mišinio ASR/AUR Leistina signalizacijos suveikimo paklaida iki 12,5±6,5 % ASR/AUR; (5...50) % degių dujų, garų ir jų mišinių ore ASR/AUR Leistina signalizacijos suveikimo paklaida iki 30 % degių dujų, garų ir jų mišinių su oru 30± ¹⁹ / ₂₄ % ASR/AUR.	Metrologinė patikra	SPM 156667399-01:2024
Sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją Sprogių/degių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai (0...50) % metano - oro mišinio ASR/AUR matavimo paklaida ± 5 % ir didesnė Deguonies dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai (0...30) % tūrio O ₂ ; matavimo paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 111950581-121:2025

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas